

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)  
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

ГОСТ  
33578—  
2015

---

**УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ**  
**Стандартный метод определения рН**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2016

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации материалов и технологий» (ФГУП «ВНИИ СМТ») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 27 октября 2015 г. № 81-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 марта 2016 г. № 149-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33578—2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2017 г.

5 Настоящий стандарт идентичен стандарту ASTM D 3838—05 (Reapproved 2011) Standard Test Method for pH of Activated Carbon (Стандартный метод определения pH активированного угля).

Стандарт разработан комитетом ASTM D28 «Активированный уголь», и непосредственную ответственность за разработку метода несет подкомитет D28.02 «Оценка жидкой фазы».

Перевод с английского языка (en).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5—2001 (подраздел 3.6).

Официальные экземпляры стандарта ASTM, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и стандартов ASTM, на которые даны ссылки, имеются в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным стандартам ASTM приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия — идентичная (IDT)

### 6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))*

© Стандартиформ, 2016

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

---

**УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ**  
**Стандартный метод определения pH**

Activated carbon. Standard test method for determination of pH

---

Дата введения — 2017—04—01

## 1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод определения pH водной вытяжки активированного угля.

1.2 В настоящем стандарте все единицы измерения приведены в системе СИ. Никакие другие единицы измерений в настоящий стандарт не включены.

1.3 В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности, связанных с его использованием. Пользователь стандарта несет ответственность за обеспечение соответствующих мер безопасности и охраны здоровья и определяет целесообразность применения законодательных ограничений перед его использованием. Меры предосторожности приведены в разделе 6.

## 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

### 2.1 Стандарты ASTM<sup>1)</sup>

ASTM D 1193 Specification for Reagent Water (Спецификация лабораторной воды)

ASTM D 1293 Test Methods for pH of Water (Методы определения pH воды)

ASTM D 2867 Test Methods for Moisture in Activated Carbon (Методы определения влаги в активированном угле)

ASTM D 6851 Test Method for Determination of Contact pH with Activated Carbon (Метод определения контактного pH с активированным углем)

ASTM E 300 Practice for Sampling Industrial Chemicals (Практика отбора проб промышленных химических продуктов)

## 3 Сущность метода

3.1 Пробу активированного угля кипятят в лабораторной (дистиллированной) воде с использованием пробки с обратным холодильником для рециркуляции водяного пара. Полученную смесь фильтруют, фильтрат охлаждают до 50 °С и определяют его pH электрометрическим измерением.

## 4 Назначение и применение

4.1 При прохождении жидкости, содержащей адсорбируемые вещества, через слой активированного угля могут возникать химические реакции между активированным углем, безуглеродными составляющими и адсорбируемыми веществами, содержащимися в жидкости. pH угля может быть существенным параметром такой реакции и, как следствие, важной характеристикой активированного угля.


<sup>1)</sup> Уточнить ссылки на стандарты ASTM можно на сайте ASTM: [www.astm.org](http://www.astm.org) или в службе поддержки клиентов ASTM: [service@astm.org](mailto:service@astm.org). В информационном томе ежегодного сборника стандартов (Annual Book of ASTM Standards) следует обращаться к сводке стандартов ежегодного сборника стандартов на странице сайта.

## 5 Аппаратура и материалы

5.1 Аналитические весы с пределом взвешивания 100 г и точностью взвешивания  $\pm 0,01$  г.

5.2 Электрическая плитка.

5.3 Стекланные детали установки для кипячения с обратным холодильником (рисунок 1). Рисунок 1 приведен для примера и демонстрирует набор стандартного оборудования, доступного у многих фирм — поставщиков лабораторного оборудования. «Цельностеклянные» элементы со стандартными коническими и шаровыми соединениями предотвращают загрязнение оборудования и таким образом снижают периодичность его обслуживания. Обратный клапан в указанном положении имеет важное значение для снижения давления со сведением к минимуму при этом потерь пара.

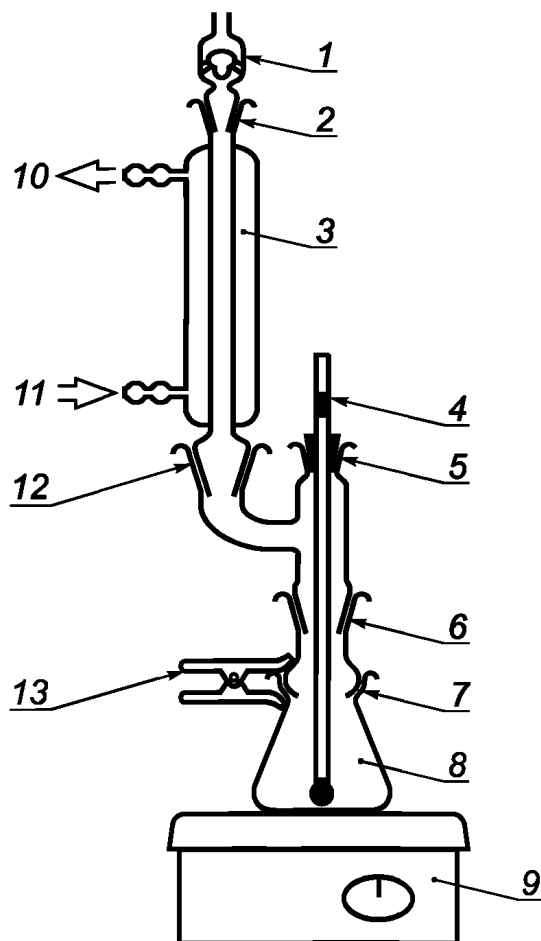

1 — обратный клапан; 2 — стандартное коническое соединение (шлиф) 20/40; 3 — конденсатор-холодильник Либиха, длина корпуса — более 250 мм; 4 — показание термометра, равное 110 °С; 5 — адаптер для термометра с винтовым уплотнительным кольцом под стандартное коническое соединение (шлиф) 10/30; 6 — стандартное коническое соединение (шлиф) 20/40; 7 — шаровое соединение 25/20; 8 — коническая колба вместимостью 250 мл; 9 — электрическая плитка; 10 — выход охлаждающей воды; 11 — поступление охлаждающей воды; 12 — стандартное коническое соединение (шлиф) 20/40; 13 — зажим шарового соединения

Рисунок 1 — Установка для кипячения с обратным холодильником

5.4 Стекланный термометр диапазоном измерения температуры примерно от 0 °С до 120 °С, достаточно длинный, чтобы можно было считывать показания на уровне 100 °С, когда он помещен на основании конической колбы (рисунок 1).

5.5 Стекланный термометр диапазоном измерения температуры примерно от 20 °С до 55 °С.

5.6 Градуированный цилиндр вместимостью 100 мл.

5.7 Стекланный стакан вместимостью 200 мл.

5.8 Фильтр-воронка.

5.9 Бумажный фильтр средней плотности качественный диаметром 12,5 см или более.

5.10 Таймер.

5.11 pH-метр, соответствующий требованиям ASTM D 1293, тип II (предпочтительна автоматическая термокомпенсация).

5.12 Лабораторная вода типа II по ASTM D 1193.

## 6 Меры предосторожности

6.1 Метод испытания включает в себя перемещение кипятка между емкостями; поэтому необходимо использовать подходящие щипцы или перчатки. Кроме того, использование электрической плитки и

pH-метра (если он работает от электросети) представляет опасность поражения электрическим током. Оборудование должно быть заземлено и изолировано в соответствии со стандартами UL и электротехническими правилами и нормами.

## 7 Подготовка пробы

7.1 Подготовка проб активированного угля проводят по ASTM E 300.

## 8 Калибровка и градуировка

8.1 pH-метр калибруют перед измерением по ASTM D 1293.

## 9 Проведение испытания

9.1 Определяют массовую долю влаги в угле по ASTM D 2867. Рассчитывают массу влажного угля, эквивалентного 10 г на сухое состояние.

9.2 Взвешивают пробу угля, эквивалентную  $(10,00 \pm 0,01)$  г сухой пробы угля. Вынимают колбу для кипячения из установки и помещают в нее пробу угля.

9.3 Доводят примерно 110 мл лабораторной воды до начала кипения. Градуированным цилиндром отмеряют  $(100,0 \pm 0,1)$  мл воды, пока она горячая. Сразу добавляют эту воду к углю в колбе. Повторно соединяют шлиф с колбой, установленной на электрической плитке.

9.4 Доводят воду в колбе до кипения, используют термометр, чтобы убедиться, что не происходит ложного кипения из-за газов, поглощенных углем.

9.5 Медленно кипятят в течение  $(900 \pm 10)$  с.

9.6 Снимают колбу с электрической плитки и быстро фильтруют ее содержимое через бумажный фильтр, предварительно смоченный дистиллированной водой, используемой для проведения испытания. Помещают фильтрат в колбу для фильтрации под вакуумом вместимостью 500 мл, соблюдая осторожность, чтобы не допустить попадания частичек угля в колбу при переливании.

9.7 Охлаждают фильтрат до  $(50 \pm 5)$  °С.

9.8 Измеряют pH по ASTM D 1293.

## 10 Обработка результатов

10.1 Если pH-метр откалиброван в единицах pH, то считают значение pH-метра. Если pH-метр показывает результаты в единицах напряжения, то используют формулу, приведенную в ASTM D 1293, раздел «Терминология».

## 11 Протокол испытаний

11.1 Протокол испытаний должен содержать:

11.1.1 источник получения угля;

11.1.2 тип или обозначение активированного угля;

11.1.3 наименование поставщика;

11.1.4 обозначение класса поставщика (торговой марки);

11.1.5 номер поставляемой партии;

11.1.6 массовую долю влаги по ASTM D 2867;

11.1.7 pH с точностью до 0,1;

11.1.8 температуру измерения с точностью до 1 °С;

11.1.9 дату проведения испытания;

11.1.10 фамилию и подпись лаборанта, который провел испытание,

и

11.1.11 фамилию и подпись руководителя, одобрявшего результаты испытания.

## 12 Прецизионность и отклонение

12.1 Межлабораторные сравнительные испытания четырех типов активированных углей по методу испытаний, регламентированному настоящим стандартом, были проведены в четырех лабораториях (см. метод испытаний по ASTM D 6851). При этом были получены следующие результаты:

Проба	Количество испытаний	Среднее значение рН	Стандартное отклонение
2N	11	3,65	0,18
11N	12	3,64	0,19
12N	11	3,56	0,14
1D	11	5,57	0,67
4D	12	5,62	0,60
9D	12	5,65	0,60
3B	11	8,82	0,38
5B	12	8,93	0,30
10B	12	8,90	0,29
6P	11	7,91	0,17
7P	12	8,07	0,41
8P	12	7,85	0,23

12.2 Измеренные значения рН находятся в зависимости от типа активированного угля (N — древесная основа; D — лигнит; B и P — каменноугольная основа). Стандартные отклонения также зависят и от других условий, они выше для нейтральной среды (примерно рН 7), чем для сильнокислой или щелочной среды. Некоторые из наблюдаемых различий вызваны самими пробами. Стандартное отклонение 0,6 для значений рН примерно 7 и 0,3 для значений на концах шкалы рН являются достижимыми для настоящего метода испытаний.

**Приложение ДА  
(справочное)**

**Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным стандартам ASTM**

Таблица ДА.1

Обозначение и наименование ссылочного стандарта ASTM	Степень соответствия	Обозначение и наименование межгосударственного стандарта
ASTM D 1193 Спецификация лабораторной воды	—	*
ASTM D 1293 Методы определения pH воды	—	*
ASTM D 2867 Методы определения влаги в активированном угле	—	*
ASTM D 6851 Метод определения контактного pH с активированным углем	IDT	ГОСТ 33621—2015 Уголь активированный. Стандартный метод определения контактного pH
ASTM E 300 Практика отбора проб промышленных химических продуктов	—	*
<p>* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного стандарта.</p> <p>П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: IDT — идентичные стандарты.</p>		

Ключевые слова: активированный уголь, определение pH, стандартный метод

---

Редактор *Л.И. Нахимова*  
Технический редактор *В.Ю. Фотиева*  
Корректор *Л.С. Лысенко*  
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 14.04.2016. Подписано в печать 22.04.2016. Формат 60×84 $\frac{1}{8}$ . Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,65. Тираж 31 экз. Зак. 1134.

---

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)